




OPPK
OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST




DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

v zadávacím řízení

„Dodání laboratorních přístrojů pro projekt Výzkumné laboratoře buněčné biologie a metabolomiky“

ZADAVATEL: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta
Adresa: Praha 2, Kateřinská 1660/32, PSČ 121 08
Zastoupený: Prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA, děkanem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
IČ: 00216208

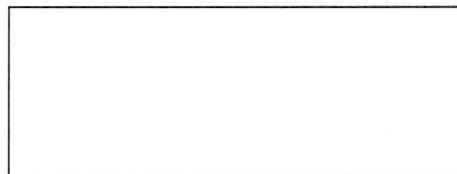

V Praze dne 25. 5. 2011

Vážení,

zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na dodávky zadané v otevřeném řízení dle zákona „Dodání laboratorních přístrojů pro projekt Výzkumné laboratoře buněčné biologie a metabolomiky“, vyhlášené v informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem 60060215.

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 - Část 4 :


Žádáme o bližší specifikace sond pro pokrytí pracovního objemu 0,2 - 500 ml (vybrané pracovní rozsahy, typ použití).

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

| pracovní rozsah (objem vzorku) | typ použití | příslušenství | pozn. 1 |
|--------------------------------|--|---|---|
| 0,2ml do 50ml | sonikace buněk (leukocyty, fibroblasty atd.) | dodání sond včetně prodlužujících nástavců (jsou-li k dispozici) umožňující sonikaci v mikrozkušnicích (objem do 2ml) ve zkumavkách (objem do 15ml), centrifugačních zkumavkách (objem do 50ml) | maximální povolený výkon sondy pro sonikaci nízkých objemů (sonda pro objem od 0,2ml) může být nižší než 400W |



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



EVROPSKÁ UNIE

| | | | |
|-------------|---|---|---|
| 1ml - 500ml | sonikace tkáňových homogenátů (sval, játra, srdce...) | dodání sond včetně prodlužujících nástavců (jsou-li k dispozici) umožňující sonikaci v mikrozkušnicích (objem do 2ml) ve zkumavkách (objem do 15ml), centrifugačních zkumavkách (objem do 50ml) | maximální povolený výkon sondy pro sonikaci nízkých objemů (sonda pro objem od 1ml) může být nižší než 400W |
|-------------|---|---|---|

Výběr sond musí být takový, aby byla k dispozici sonda pro každý možný objem v rámci požadovaného pracovního rozsahu!

S pozdravem

Mgr. Jana Zedníková

za pověřenou osobu

A.I. Consulting s.r.o.

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 129850

IČ: 28163974

gsm: +420 775 714 132

e-mail: zednikova@aiconsulting.cz