


Univerzita Karlova v Praze  
1.lékařská fakulta  
Děkanát  
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

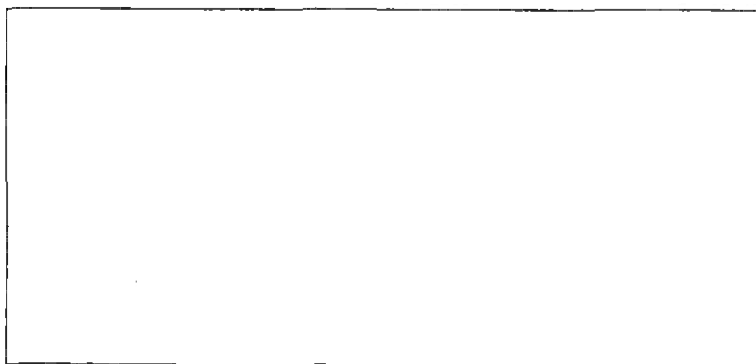

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
913/20110022


VYŘIZUJE/LINKA  
Vacková/ 4338

PRAHA  
24.10.2011

VĚC:

**Hlubokomrazící boxy 5ks - pro biobanku**, evidenční číslo: 913/20110022 - zaslání odpovědi na dotaz k Poptávce - Výzvě k podání nabídky a k prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 6 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zasíláme Vám odpověď na dotaz, který byl vznesen od vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu.

  
Mgr. Marta Mengerová, MBA  
vedoucí grantového oddělení

## ZADAVATEL

Univerzita Karlova v Praze se sídlem Praha 1, Ovocný trh 3-5, PSČ: 116 36  
týká se součástí 1. lékařská fakulta Praha 2, Kateřinská č.p. 1660/32, PSČ: 121 08

Vážení,

zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu: **Hlubokomrazicí boxy 5ks - pro biobanku , evidenční číslo: 913/20110022**

### Znění dotazu:

U položky 2 (skříňový hlubokomrazicí box -86°C) je požadován užitečný objem min. 500 litrů a současně je požadována kapacita min. 500 kusů 2“ krabiček na kryozkumavky. Vzhledem k tomu, že u skříňových hlubokomrazicích boxů s objemem 500 l až 600 l je kapacita 2“ krabiček cca 350 ks, domníváme se, že došlo k chybě v textu zadání. Správně má být uvedeno minimálně 350 kusů 2“ krabiček místo 500 ks.

### Původní text položky č.2

#### 2) 1ks - skříňový hlubokomrazicí box -86°C

- Užitečný objem min. 500 litrů
- Zálohovací systém s preferencí duálního chladicího systému
- Grafický displej s pamětí pro data
- VIP tenká vakuová izolace
- Možnost nastěhování dveřmi šířky 80 cm
- Min. 4 police s libovolně nastavitelnou roztečí
- Kapacita min. 500 kusů 2“ krabiček na kryozkumavky
- Vakuový ventil (systém bránící přimrzávání dveří)
- Garantovaná teplota -86°C (při teplotě místností min. 30°C)
- Vnitřní izolované dveře
- Bezfiltrový systém
- USB port pro přenos dat do počítače
- Alarm funkce

### Opravený text položky č.2

#### 2) 1ks - skříňový hlubokomrazicí box -86°C

- Užitečný objem min. 500 litrů
- Zálohovací systém s preferencí duálního chladicího systému
- Grafický displej s pamětí pro data
- VIP tenká vakuová izolace
- Možnost nastěhování dveřmi šířky 80 cm

- Min. 4 police s libovolně nastavitelnou roztečí
- Kapacita min. 350 kusů 2“ krabiček na kryozkumavky
- Vakuový ventil (systém bránící přimrzávání dveří)
- Garantovaná teplota -86°C (při teplotě místností min. 30°C)
- Vnitřní izolované dveře
- Bezfiltrový systém
- USB port pro přenos dat do počítače
- Alarm funkce



Mgr. Marta Mengérová, MBA  
vedoucí grantového oddělení